

Медичний прилад для автоматичного неінвазивного скринінгу та діагностики здоров'я пацієнтів на основі аналізу термодинамічних параметрів

реалізується під комерційними назвами:

Автоматичний Неінвазивний Експрес Скринінг Аналізатор **ANESA®**

Automatic Noninvasive Express Screening Analyzer **ANESA®**

Медичний прилад для діагностики **DIAMEDSCAN**

Medical device for diagnosis **DIAMEDSCAN**

Аналізатор неінвазивний формули крові **АМП**

Аналізатор неінвазивний формули крові **АМП-РС**

Noninvasive Hemogram Analyzer **AMP**

Прилад діагностики та неінвазивний аналізатор **DAD-ANI®**

Dispositivo de Ayuda al Diagnóstico y Analizador No Invasivo **DAD-ANI®**

(далі по тексту АНАЛІЗАТОР)

НАСТАНОВА ЩОДО ПІД'ЄДНАННЯ МЕДИЧНОГО ПРИБОРУ ДО КОМП'ЮТЕРА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH



UA.TR.099

2021

ПІД'ЄДНАННЯ МЕДИЧНОГО ПРИСТРОЮ ДО КОМП'ЮТЕРА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH




Тільки для моделей обладнаних модулем BLUETOOTH.

Включіть медичний прилад, для цього натисніть та утримуйте кнопку «POWER». Після трьох секунд утримання засвітиться зелений світлодіод.




Створення Bluetooth пари АНАЛІЗАТОРА та комп'ютера.


OS Windows, виберіть меню "Settings".

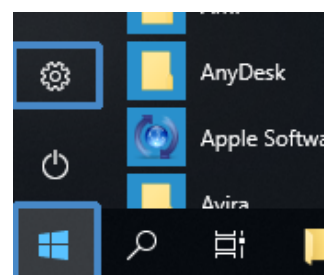


Виберіть меню "Devices"

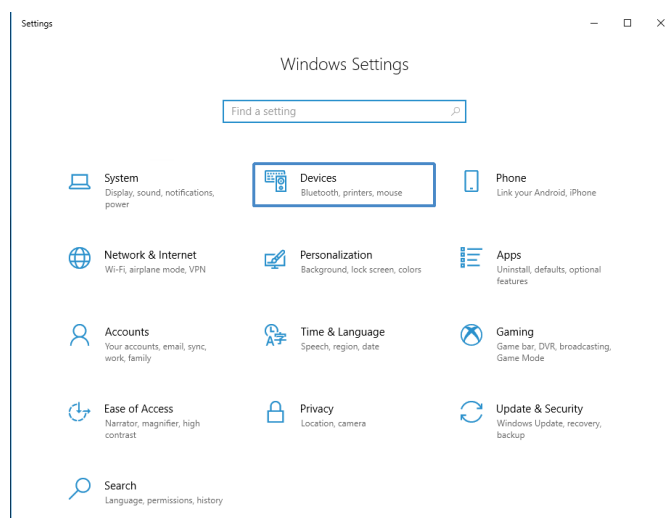


Включіть Bluetooth і додайте Bluetooth пристрій:
“+ Add Bluetooth or other device”

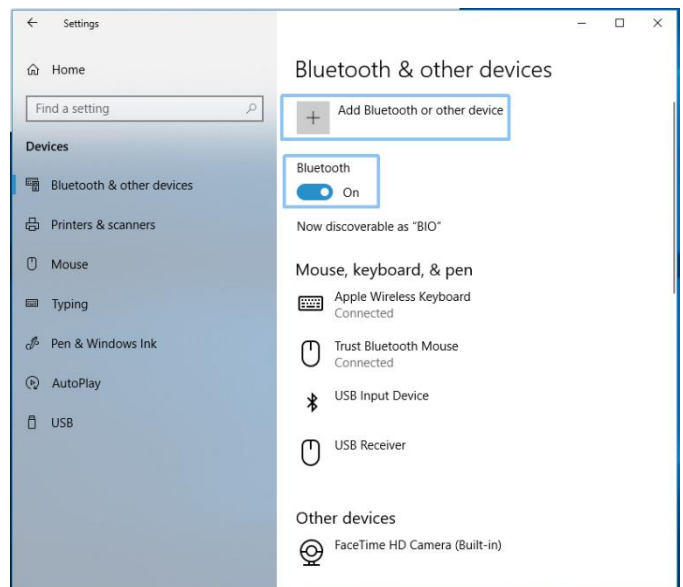


Виберіть меню “Bluetooth”

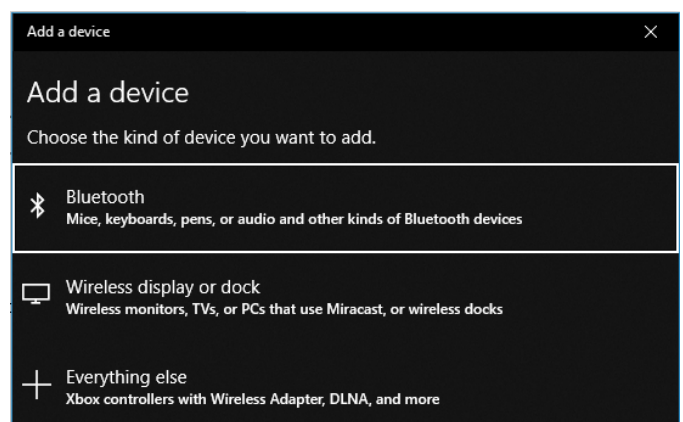


Додайте АНАЛІЗАТОР
(ANESA00001 the serial number will be visible here)

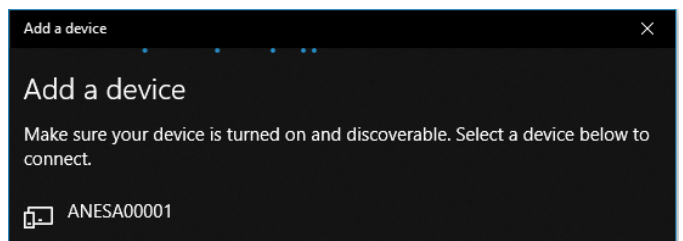


Операційна система запросить пароль:

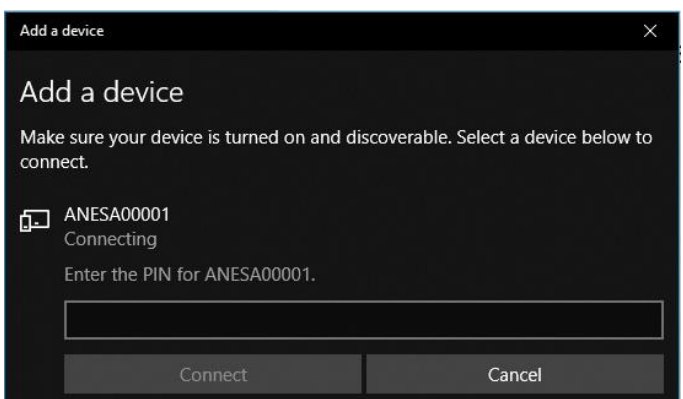


Введіть пароль: **1234** та натисніть “Connect”

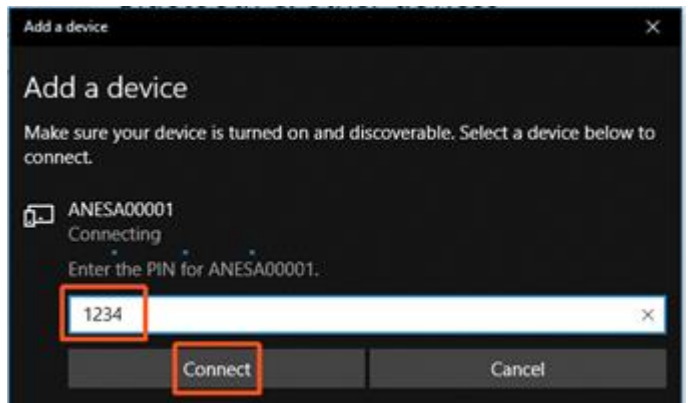

Для Model-19 необхідно ввести пароль **12345** та натиснути “Connect”

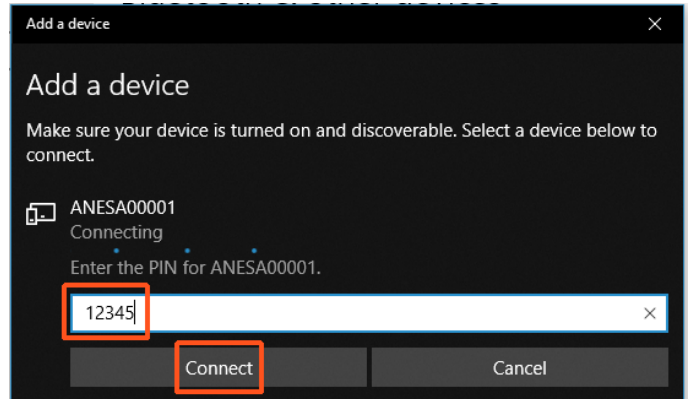


Якщо пароль було введено неправильно або ви його довго не вводили, з'явиться таке повідомлення:

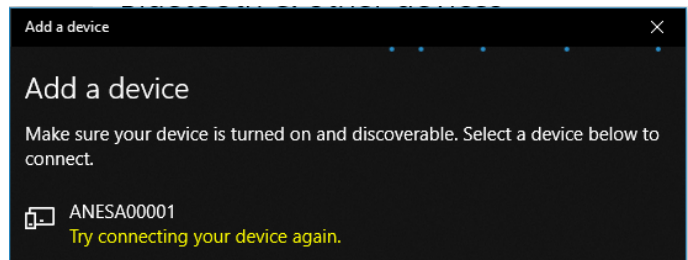


Спробуйте підключити свій пристрій ще раз.

У правому нижньому куті інтерфейсу Windows відображається повідомлення: "Пристрій готовий до використання" ("The device is ready")

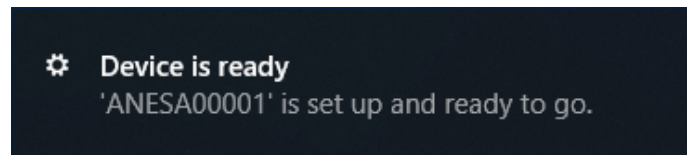

Натисніть "Done" для продовження.

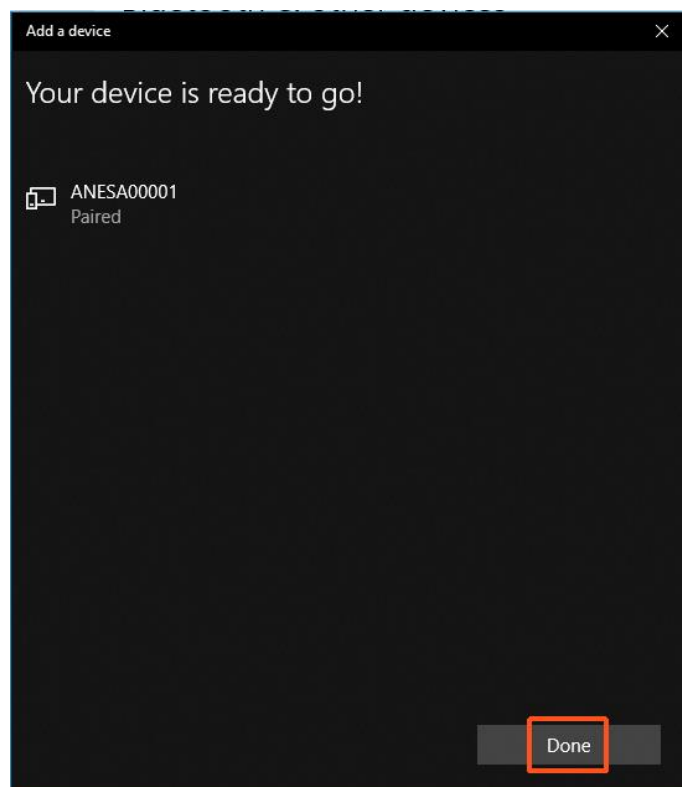


Якщо з'єднання АНАЛІЗАТОРА та комп'ютера через канал Bluetooth пройде успішно, на передній панелі пристрою загориться синій світлодіод (під знаком Bluetooth).



Щоб перевірити правильність підключення пристрою до комп'ютера, скористайтеся меню Налаштування ОС Windows.

АНАЛІЗАТОР з його серійним номером буде вказаний у відповідному списку пристроїв Bluetooth.

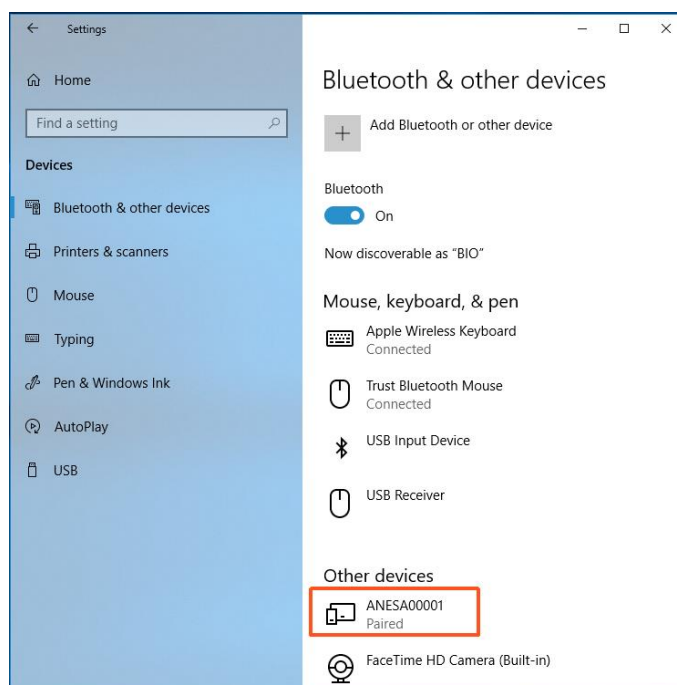


Запустіть програмне забезпечення за допомогою піктограми



або



Після запуску програмного забезпечення USPIH, будь ласка, натисніть комбінацію клавіш Ctrl +Alt +B і зачекайте, поки програмне забезпечення USPIH знайде пристрій ANALYZER. Якщо з'єднання пройде успішно, знак Bluetooth у програмному забезпеченні USPIH буде виділено (синій колір; не блимаючи). Тепер можна проводити тестування пацієнтів.

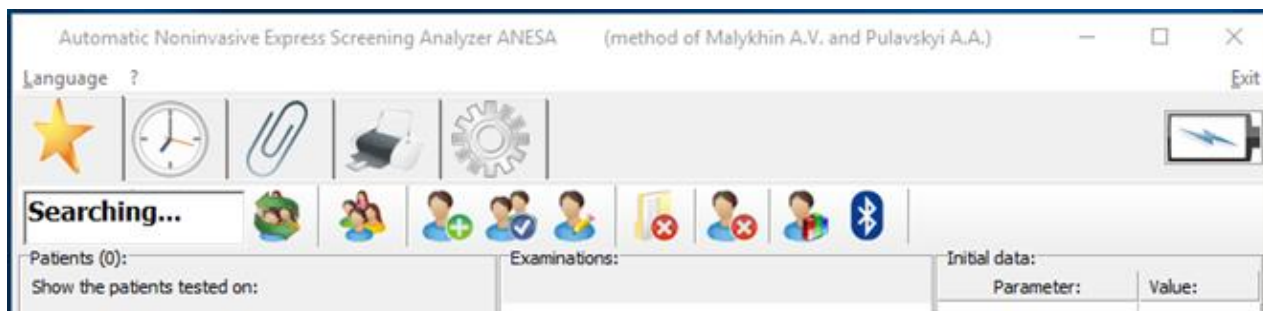

ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТУ ТА КОНТРОЛЬ ВЕРСІЙ

Версія	Дата	Коротко про зміни	Автор	Відповідні параграфи/ документи
1.0	2021-05-27	Видано	Пулавський А.	